

精明选购 及正确使用 男性安全套




医疗仪器科
Medical Device Division
www.mdd.gov.hk



衛生署
Department of Health


安全套

在「医疗仪器行政管理制度」下，安全套通常属于第III级中高风险的一般医疗仪器。但含有药剂制品（例如：麻醉药）的安全套，则属于第IV级高风险一般医疗仪器



每次性行为都要正确地使用安全套

- ✓ 透过物理屏障的方式防止精子进入女性的生殖器官来避孕
- ✓ 预防性传播感染，例如爱滋病、梅毒、淋病（俗称白浊）、非淋病性尿道炎（男性）/ 非特异性生殖道感染（女性）、性病疣（俗称椰菜花）、阴部疱疹与阴虱等




性传播感染

性传播感染是透过性行为传播，例如阴道性交、口交和肛交

患有性传播感染不但会增加感染爱滋病病毒的风险，也可能导致其他严重的健康后果，例如不育，甚至死亡。另外，感染者亦可能会透过母婴传染影响新生儿，例如先天性缺陷

正确地使用安全套可有效地降低性传播感染风险和避孕


正确使用安全套

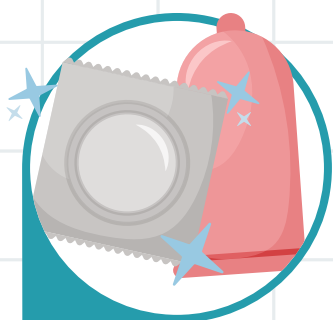

- ✓ 每次性行为时，使用一个**新的安全套**
- ✓ 如有需要，可使用**水溶性润滑剂**。油性润滑剂可能会导致安全套破裂，降低安全套效能

! 正确使用安全套

有效期限：XX-XX-XXXX

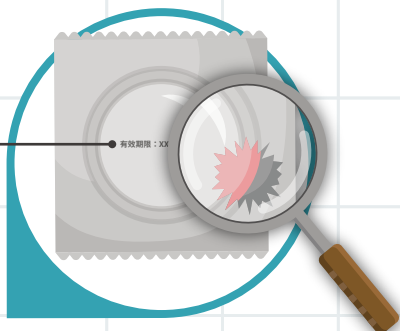

使用前要检查**有效期限**和**包装的完整性**，以确保安全套的效能



细阅及遵从使用说明，包括用后处理方法。用完的安全套应用纸巾包裹好，弃置于垃圾箱内



如对正确使用安全套有疑问，请咨询**医护专业人员**

! 精明选购安全套



表列号码

HKMD No. XXXXXX



MDACS



选购已于「**医疗仪器行政管理制度**」表列，并附有**表列号码**的安全套，以确保安全套能符合表列制度下**安全、品质及性能**的要求

* 你可以在**医疗仪器科网站**上的**医疗仪器列表**搜寻已表列仪器的资料

🔍 更多资讯关于已表列的安全套，
请参阅医疗仪器科相关专题网页

安全套的专题网页

<https://www.mdd.gov.hk/sc/information-publication/thematic-pages/index.html>



表列号码
(HKMD No.)

制造商

品牌及型号

本地负责人

包装



医疗仪器科